

Reparaturbegleitschein

Rigid Endoscope

Olympus®, Storz®, Wolf®, Stryker®, diverse



Service Nummer: _____

Gültig ab:
17.09.2021

Freigabe
Ufuk Özgentürk

Revision
2

Seite 4 von 6

DCN 1

Sehr geehrter Kunde,
um Ihr Anliegen so schnell wie möglich bearbeiten zu können, bitten wir Sie, uns den Grund für die Reparatur so genau wie möglich zu beschreiben.

Anschrift (ggf. Stempel)

Name: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Gerätetyp

Hersteller: _____

Modell/Art.-Nr.: _____

Seriennummer: _____

Starres Endoskop (bitte zutreffenden Defekt ankreuzen)

Starre Endoskope

- undicht
- Oberfläche beschädigt
- Keine Sicht

Instrumentenkanal (Wenn vorhanden)

- undicht
- verengt

Okular

- undicht
- trübe
- Bild gestört

Distalende


- Linsen/Optik
- Licht

Schaft

- gebogen
- Linsen gebrochen

Lichtleiteranschluss

- Lichtleistung
- Adapter

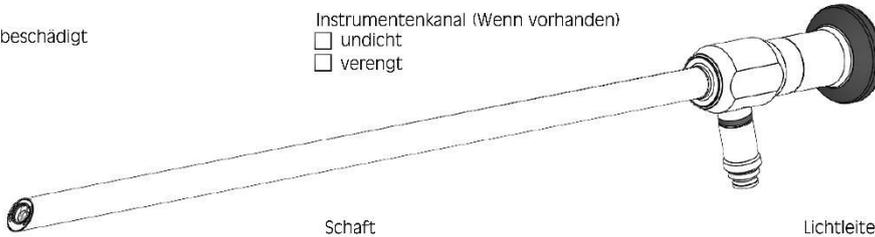

Anmerkungen / Fehlerbeschreibung

Sicherheitsinformation zum Schutz unserer Mitarbeiter

Nachweis der Dekontamination (bitte zutreffendes ankreuzen)



Im Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG) und in der Aufbereitung von Produkten für die Gesundheitsfürsorge (DIN EN ISO 17664) sind an die Aufbereitung von gebrauchten Medizinprodukten zahlreiche gesetzliche Anforderungen formuliert. Da diese Medizinprodukte eine Quelle von Infektionen beim Menschen sein können, ist eine sach- und fachgerechte Aufbereitung dieser Medizinprodukte ein unverzichtbares Muss.

Ja, das Produkt wurde manuell dekontaminiert. Name Mitarbeiter: _____

Ja, das Produkt wurde maschinell dekontaminiert. Batch-Nr.: _____

Nein, das Produkt konnte nicht dekontaminiert werden*. Grund: _____

Bitte Verpackung von außen deutlich kennzeichnen, dass Gerät nicht dekontaminiert ist!

Hiermit bestätige ich die Angaben:

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr EMOS- Team